


検診車 Q 説明書

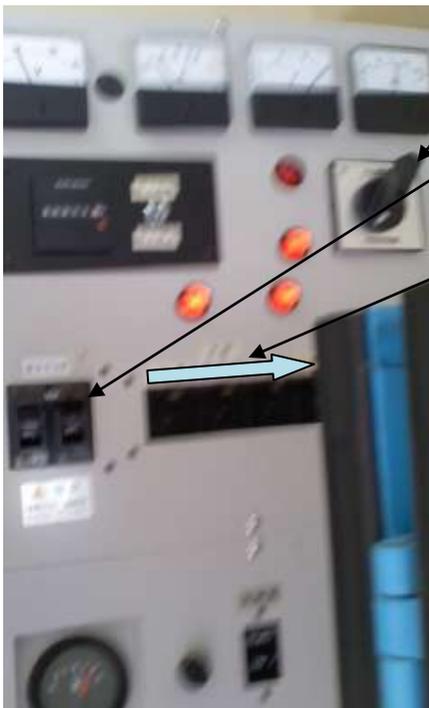

発電機始動・・・長押し上げ（15秒ぐらい）

メイン電源：ON

システム電源：ON



UPS 電源 ON

蓋をあける



Canon システムサーバーON



電源スイッチ

130キロボルト標準設定




ナンバーリング設定




ブルーに反転している場合撮影
できません：グリーンの ready
にて撮影可能

OK クリック


修正不要の場合 OK で終了

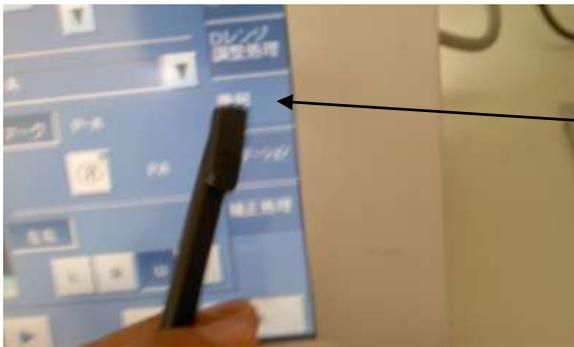

幾何をクリックする

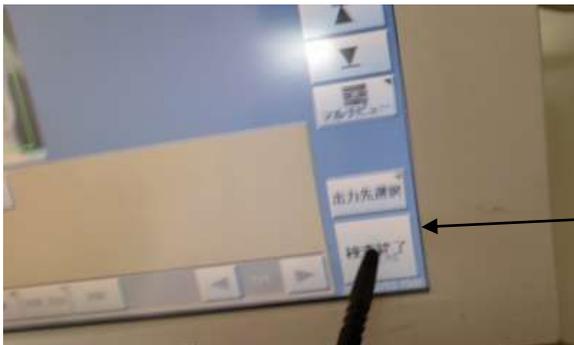

検査終了

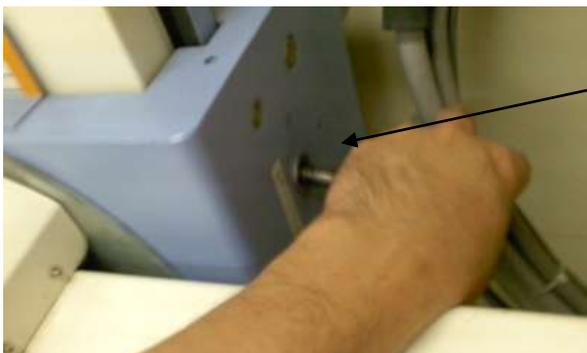

全て終了装置 OFF

固定ボルトをさし込み固定
ベルトで管球とデテクターを締
め固定

